

# 校正証明書

試験実施日 2021 年 8 月 26 日 ( 木 )

室温 25.3 °C 湿度 59 %

名称	パワーマルチメータ	形式	2721
製造者	エヌエフ回路設計ブロック	製造番号	307999
製造年月	-	-	-
定格	電圧入力レンジ 1/2.5/5/10/20/40/80/160/320/640V 電流入力レンジ 40mA/100mA/200mA 0.4/0.8/1.6/3.2/6.4/12/24A		

依頼者	セキデンエンジニアリング株式会社				
住所	東京都江戸川区北葛西2-29-15				
校正項目	電圧、電流、電力				
校正方法	日本の公的校正機関(JEMIC、JQA、JCSS等)またはNIST等、国際度量衡委員会に加盟している諸外国の公的校正機関に対してトレーサビリティーが保たれた標準器との比較により行う。				
校正室の環境条件	温度23±5°C 湿度35%~75%				
	環境標準器	名称 デジタル温湿度計	型式 CHT-230	製造番号 21G066	校正有効期限 2022年7月
校正実施場所	茨城県つくば市臼井1954-1 つくば電気管理事務所 試験室				

上記の測定器は当社の校正機器によって校正され、校正作業における検査または試験の結果は仕様を満足しています。

この校正に使用した校正機器は、国家標準或いは国際標準へのトレーサビリティーがとれていることを証明します。


つくば電気管理事務所  
代表 鈴木 研志  
〒300-4211 茨城県つくば市臼井2024



# トレーサビリティ体系図

試験実施日 2021 年 8 月 26 日 ( 木 )

室温 25.3 °C 湿度 59 %

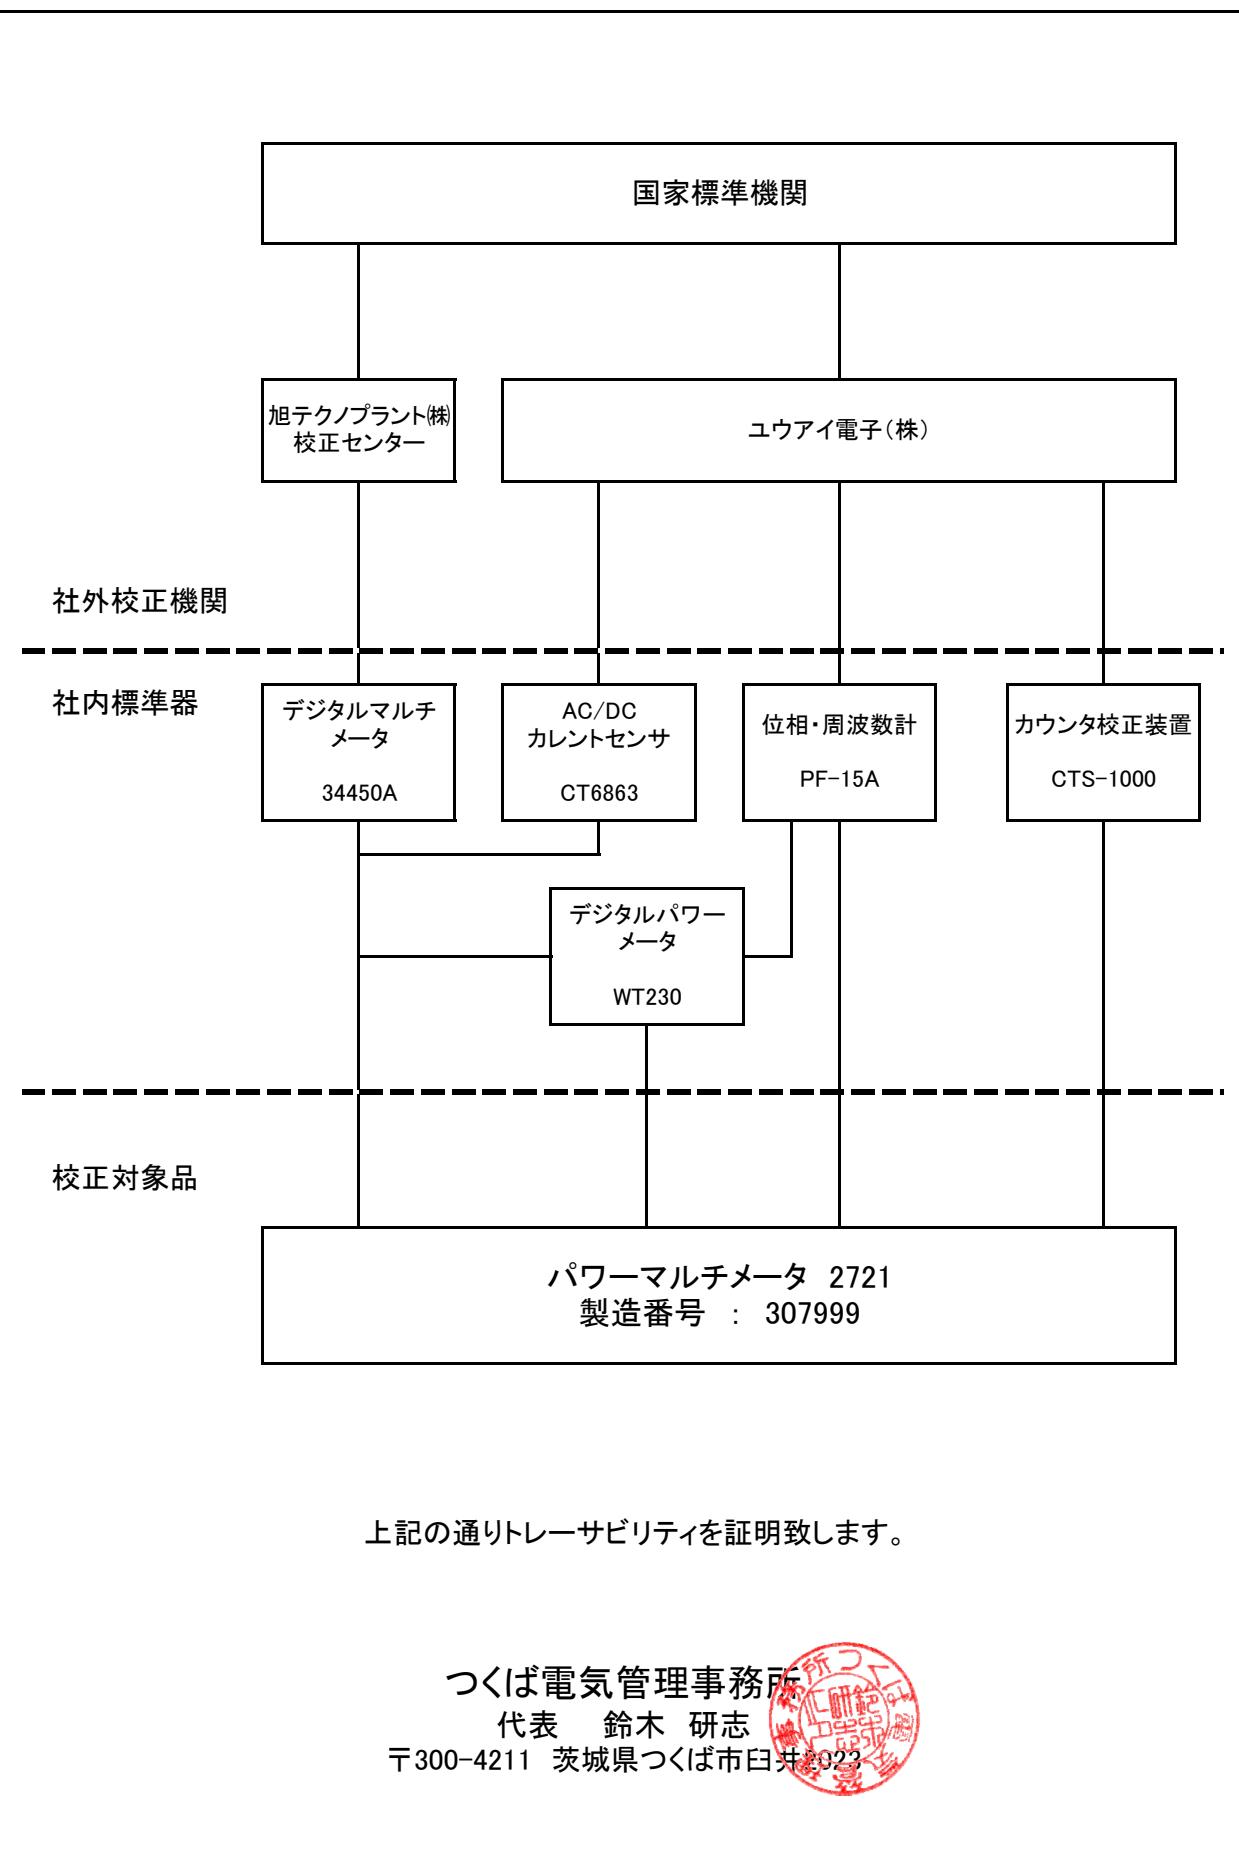

# 校正試験成績書

試験実施日 2021 年 8 月 26 日 (木)

室温 25.3 °C 湿度 59 %

試験実施者 鈴木 研志

名称	パワーマルチメータ	形式	2721
製造者	エヌエフ回路設計ブロック	製造番号	307999
製造年月	-	-	-
定格	電圧入力レンジ 1/2.5/5/10/20/40/80/160/320/640V 電流入力レンジ 40mA/100mA/200mA 0.4/0.8/1.6/3.2/6.4/12/24A		

## 1.交流電圧

### 1.1 V1

レンジ	標準値	基準範囲(最小値)	基準範囲(最大値)	指示値	判定(良/不良)
1 V	1 V	0.999 V	1.001 V	1.0007 V	良
2.5 V	2.5 V	2.4975 V	2.5025 V	2.4995 V	良
5 V	5 V	4.9950 V	5.0050 V	5.0004 V	良
10 V	10 V	9.9900 V	10.010 V	10.005 V	良
20 V	20 V	19.980 V	20.020 V	19.993 V	良
40 V	40 V	39.960 V	40.040 V	39.993 V	良
80 V	80 V	79.920 V	80.080 V	80.004 V	良
160 V	160 V	159.84 V	160.16 V	160.06 V	良
320 V	320 V	319.68 V	320.32 V	320.04 V	良
640 V	640 V	639.36 V	640.64 V	640.06 V	良

精度 : ±0.05%rdg+0.05%fs

### 1.2 V2

レンジ	標準値	基準範囲(最小値)	基準範囲(最大値)	指示値	判定(良/不良)
1 V	1 V	0.999 V	1.001 V	0.9995 V	良
2.5 V	2.5 V	2.4975 V	2.5025 V	2.5003 V	良
5 V	5 V	4.9950 V	5.0050 V	4.9999 V	良
10 V	10 V	9.9900 V	10.010 V	9.9952 V	良
20 V	20 V	19.980 V	20.020 V	19.991 V	良
40 V	40 V	39.960 V	40.040 V	39.988 V	良
80 V	80 V	79.920 V	80.080 V	79.965 V	良
160 V	160 V	159.84 V	160.16 V	159.99 V	良
320 V	320 V	319.68 V	320.32 V	319.96 V	良
640 V	640 V	639.36 V	640.64 V	639.95 V	良

精度 : ±0.05%rdg+0.05%fs

### 1.3 V3

レンジ	標準値	基準範囲(最小値)	基準範囲(最大値)	指示値	判定(良/不良)
1 V	1 V	0.999 V	1.001 V	0.9992 V	良
2.5 V	2.5 V	2.4975 V	2.5025 V	2.5002 V	良
5 V	5 V	4.9950 V	5.0050 V	4.9998 V	良
10 V	10 V	9.9900 V	10.010 V	9.9946 V	良
20 V	20 V	19.980 V	20.020 V	19.990 V	良
40 V	40 V	39.960 V	40.040 V	39.987 V	良
80 V	80 V	79.920 V	80.080 V	79.962 V	良
160 V	160 V	159.84 V	160.16 V	159.99 V	良
320 V	320 V	319.68 V	320.32 V	319.93 V	良
640 V	640 V	639.36 V	640.64 V	640.03 V	良

精度 : ±0.05%rdg+0.05%fs

# 校正試験成績書

試験実施日 2021 年 8 月 26 日 (木)

室温 25.3 °C 湿度 59 %

試験実施者 鈴木 研志

名称	パワーマルチメータ	形式	2721
製造者	エヌエフ回路設計ブロック	製造番号	307999
製造年月	-	-	-
定格	電圧入力レンジ 1/2.5/5/10/20/40/80/160/320/640V 電流入力レンジ 40mA/100mA/200mA 0.4/0.8/1.6/3.2/6.4/12/24A		

## 2.交流電流

### 2.1 A1

レンジ	標準値	基準範囲(最小値)	基準範囲(最大値)	指示値	判定(良/不良)
40 mA	40 mA	39.920 mA	40.080 mA	39.994 mA	良
100 mA	100 mA	99.86 mA	100.14 mA	99.949 mA	良
200 mA	200 mA	199.76 mA	200.24 mA	200.06 mA	良
0.4 A	0.4 A	0.39956 A	0.40044 A	0.40012 A	良
0.8 A	0.8 A	0.79916 A	0.80084 A	0.79943 A	良
1.6 A	1.6 A	1.5984 A	1.6016 A	1.5999 A	良
3.2 A	3.2 A	3.1968 A	3.2032 A	3.1993 A	良
6.4 A	6.4 A	6.3936 A	6.4064 A	6.3941 A	良
12 A	12 A	11.988 A	12.012 A	11.994 A	良
24 A	24 A	23.976 A	24.024 A	24.004 A	良

精度 :  $\pm 0.05\% \text{rdg} + 0.05\% \text{fs} + 40 \mu \text{A}$

### 2.2 A2

レンジ	標準値	基準範囲(最小値)	基準範囲(最大値)	指示値	判定(良/不良)
40 mA	40 mA	39.920 mA	40.080 mA	39.995 mA	良
100 mA	100 mA	99.86 mA	100.14 mA	99.982 mA	良
200 mA	200 mA	199.76 mA	200.24 mA	200.03 mA	良
0.4 A	0.4 A	0.39956 A	0.40044 A	0.40003 A	良
0.8 A	0.8 A	0.79916 A	0.80084 A	0.79932 A	良
1.6 A	1.6 A	1.5984 A	1.6016 A	1.5995 A	良
3.2 A	3.2 A	3.1968 A	3.2032 A	3.1987 A	良
6.4 A	6.4 A	6.3936 A	6.4064 A	6.3988 A	良
12 A	12 A	11.988 A	12.012 A	11.991 A	良
24 A	24 A	23.976 A	24.024 A	23.999 A	良

精度 :  $\pm 0.05\% \text{rdg} + 0.05\% \text{fs} + 40 \mu \text{A}$

### 2.3 A3

レンジ	標準値	基準範囲(最小値)	基準範囲(最大値)	指示値	判定(良/不良)
40 mA	40 mA	39.920 mA	40.080 mA	39.975 mA	良
100 mA	100 mA	99.86 mA	100.14 mA	99.963 mA	良
200 mA	200 mA	199.76 mA	200.24 mA	200.07 mA	良
0.4 A	0.4 A	0.39956 A	0.40044 A	0.40005 A	良
0.8 A	0.8 A	0.79916 A	0.80084 A	0.79940 A	良
1.6 A	1.6 A	1.5984 A	1.6016 A	1.5997 A	良
3.2 A	3.2 A	3.1968 A	3.2032 A	3.1991 A	良
6.4 A	6.4 A	6.3936 A	6.4064 A	6.3992 A	良
12 A	12 A	11.988 A	12.012 A	11.993 A	良
24 A	24 A	23.976 A	24.024 A	24.003 A	良

精度 :  $\pm 0.05\% \text{rdg} + 0.05\% \text{fs} + 40 \mu \text{A}$

# 校正試験成績書

試験実施日 2021 年 8 月 26 日 (木)

室温 25.3 °C 湿度 59 %

試験実施者 鈴木 研志

名称	パワーマルチメータ	形式	2721
製造者	エヌエフ回路設計ブロック	製造番号	307999
製造年月	-	-	-
定格	電圧入力レンジ 1/2.5/5/10/20/40/80/160/320/640V 電流入力レンジ 40mA/100mA/200mA 0.4/0.8/1.6/3.2/6.4/12/24A		

## 3.交流電力(単相,PF=1)

### 3.1 V1/A1

入力	標準値	基準範囲(最小値)	基準範囲(最大値)	指示値	判定(良/不良)
10V0.4A	4 W	3.92 W	4.08 W	3.9997 W	良
80V3.2A	256 W	250.88 W	261.12 W	255.49 W	良

確度： ±(0.1%rdg+0.1%fs+ΔF%rdg) ≒ ±2%とする

### 3.2 V2/A2

入力	標準値	基準範囲(最小値)	基準範囲(最大値)	指示値	判定(良/不良)
10V0.4A	4 W	3.92 W	4.08 W	3.9978 W	良
80V3.2A	256 W	250.88 W	261.12 W	255.34 W	良

確度： ±(0.1%rdg+0.1%fs+ΔF%rdg) ≒ ±2%とする

### 3.3 V3/A3

入力	標準値	基準範囲(最小値)	基準範囲(最大値)	指示値	判定(良/不良)
10V0.4A	4 W	3.92 W	4.08 W	3.9984 W	良
80V3.2A	256 W	250.88 W	261.12 W	255.40 W	良

確度： ±(0.1%rdg+0.1%fs+ΔF%rdg) ≒ ±2%とする

## 4.カウンタ

レンジ	指示値	基準範囲(最小値)	基準範囲(最大値)	標準値	判定(良/不良)
0~1999.99 sec	500 msec	499.4 msec	500.6 msec	499.8 msec	良
ワンショット	1.000 sec	0.9989 sec	1.0011 sec	0.9998 sec	良

確度： ±(0.1%rdg +1dgt)

## 9.校正使用機器

名称	型式	製造番号	有効期限
デジタルマルチメーター	34450A	MY57112333	2022年2月
AC/DCカレントセンサ	CT6863	90720430	2022年2月
デジタルパワーメータ	WT230	91GC19394	2022年6月
カウンタ校正装置	CTS-1000	17C110032	2022年2月

つくば電気管理事務所

